
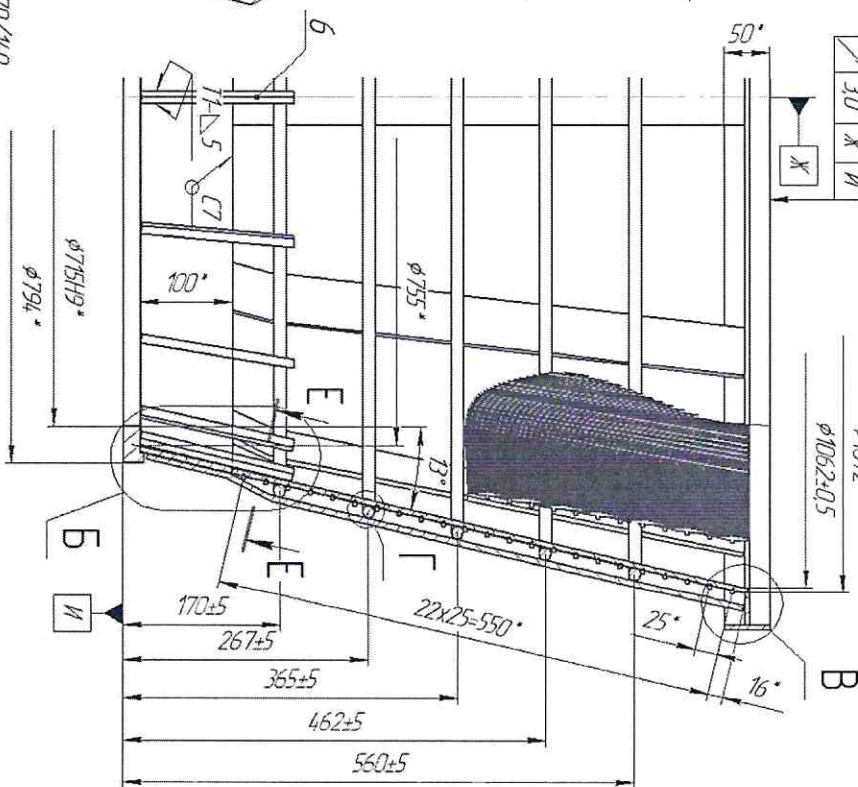
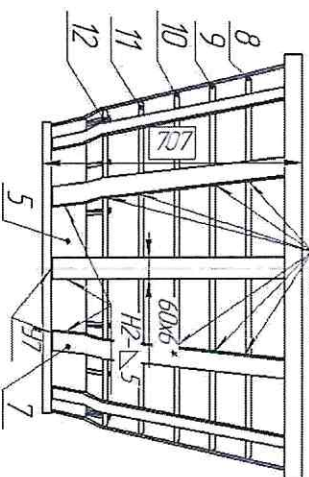
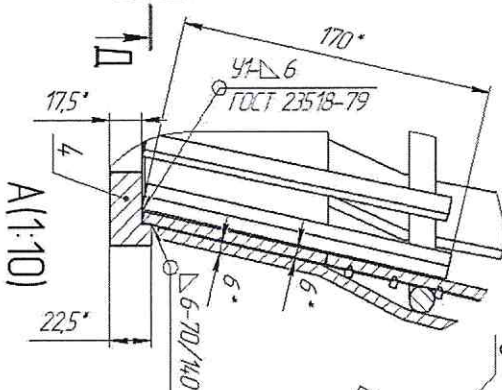

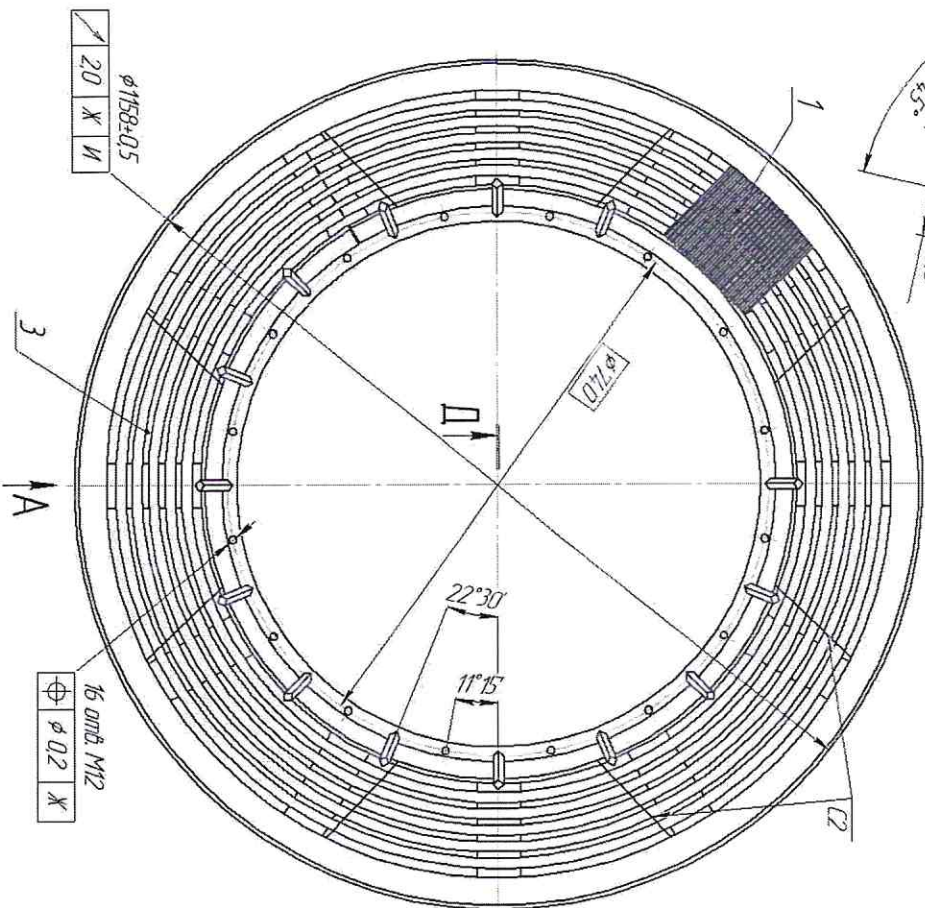
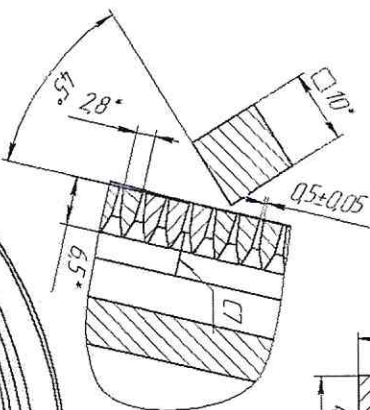
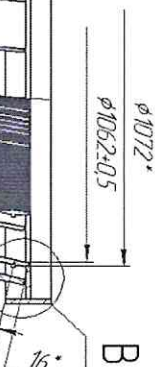

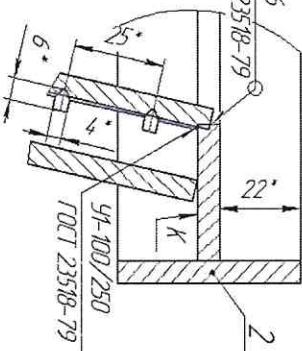
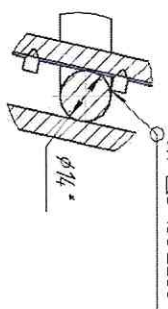




1. *Размеры для стробок.
2. Строчки и строчки пропускать на кондиционере.
3. Неукладные пределы отклонения размеров $\pm 1\%$ /2.
4. Строчки в среде защитных газом по ГОСТ 4.774-76.
5. Сечение рабочих поверхностей кромки при стробке не более 0,15 мм.
6. После строчки ротор должен стробить. Остаточный диаметр не более 0,05 мм.
7. Проверить наличие под кромкой ротора этикетки с маркировкой ПФ-ВЗ17 ВЛХУ/4, ГОСТ 926-82.

Центрифуга HSG-1100

0358.00.00.0000-06 CB

[illegible]